


测量详细信息 样品名称 WS2 操作者姓名 曾洁	测量详细信息 分析日期时间 2018/4/17 18:47:50 结果源 测量
分析 颗粒名称 W 颗粒折射率 2.240 颗粒吸收率 1.000 分散剂名称 Water 分散剂折射率 1.330 分析模型 通用 加权残差 0.27 % 激光遮光度 10.05 %	结果 径距 2.294 一致性 1.578 比表面积 1504 m ² /kg D [3,2] 3.99 μm D [4,3] 11.8 μm Dv (10) 2.01 μm Dv (50) 5.40 μm Dv (90) 14.4 μm Dv (98) 116 μm Dv (100) 271 μm

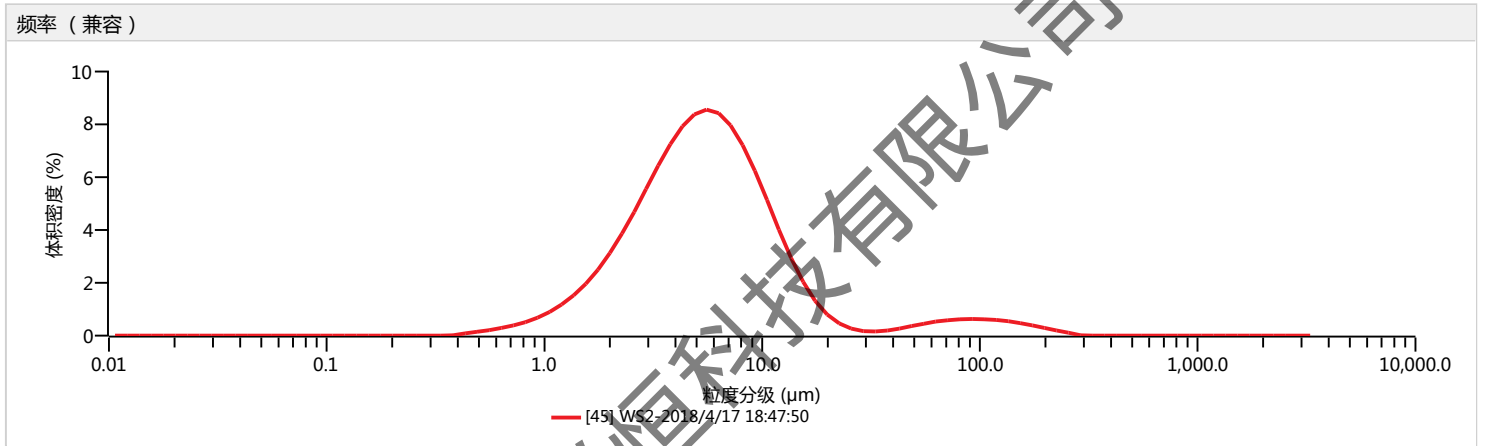

结果

粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内	粒度 (μm)	% 体积 范围内
0.0100	0.00	0.0597	0.00	0.357	0.00	2.13	3.21	12.7	2.45	76.0	0.51	454	0.00	2710	0.00
0.0114	0.00	0.0679	0.00	0.405	0.07	2.42	3.90	14.5	1.68	86.4	0.52	516	0.00	3080	0.00
0.0129	0.00	0.0771	0.00	0.460	0.11	2.75	4.63	16.4	1.09	98.1	0.51	586	0.00	3500	0.00
0.0147	0.00	0.0876	0.00	0.523	0.17	3.12	5.37	18.7	0.66	111	0.49	666	0.00		
0.0167	0.00	0.0995	0.00	0.594	0.23	3.55	6.05	21.2	0.38	127	0.45	756	0.00		
0.0189	0.00	0.113	0.00	0.675	0.32	4.03	6.62	24.1	0.21	144	0.40	859	0.00		
0.0215	0.00	0.128	0.00	0.767	0.42	4.58	7.00	27.4	0.14	163	0.32	976	0.00		
0.0244	0.00	0.146	0.00	0.872	0.56	5.21	7.16	31.1	0.12	186	0.24	1110	0.00		
0.0278	0.00	0.166	0.00	0.991	0.74	5.92	7.04	35.3	0.15	211	0.16	1260	0.00		
0.0315	0.00	0.188	0.00	1.13	0.97	6.72	6.65	40.1	0.22	240	0.09	1430	0.00		
0.0358	0.00	0.214	0.00	1.28	1.26	7.64	6.02	45.6	0.30	272	0.00	1630	0.00		
0.0407	0.00	0.243	0.00	1.45	1.63	8.68	5.21	51.8	0.37	310	0.00	1850	0.00		
0.0463	0.00	0.276	0.00	1.65	2.07	9.86	4.28	58.9	0.44	352	0.00	2100	0.00		
0.0526	0.00	0.314	0.00	1.88	2.60	11.2	3.33	66.9	0.49	400	0.00	2390	0.00		

声明:

批准: 黄志锋 审核: 曾洁 编制: 周萍

- 1、报告无检测单位公章无效, 复制报告未重新加盖单位公章无效。
- 2、本报告涂改、换页、漏页无效, 报告无审核、批准人签字无效。
- 3、对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起15日向检测单位提出, 逾期不予受理。
- 4、委托检测仅对来样负责。

单位地址: 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号中南大学粉末冶金研究院内 电话/传真: 0731-88876204 网址: <http://www.pmqst.cn/>